

Datum: juni 2024

Categorie: EUCAST waarschuwing

Onderwerp: Commerciële microdilutie cefiderocol (Thermofisher)

Opmerking: Voor de volledige tekst van de waarschuwing zie de EUCAST-website.


**Probleem:**

Resultaten cefiderocol van Sensititre panels (Thermofisher) zijn onbetrouwbaar.

**Achtergrond:**

De resultaten voor cefiderocol MICs verkregen met de Sensititre panels van Thermofisher zijn onbetrouwbaar. De fabrikant heeft hiervoor een waarschuwing afgegeven:

- Alle huidige batches
- Platen met de volgende codes: MDRGNX2F, CAN2MSTF, GNARUM6F, THAMDR1F, CMP3QLN, DEURUB1, SWEEDL1, EUSHION8, FRCNRP4
- Advies van de fabrikant: negeer het resultaat voor cefiderocol.

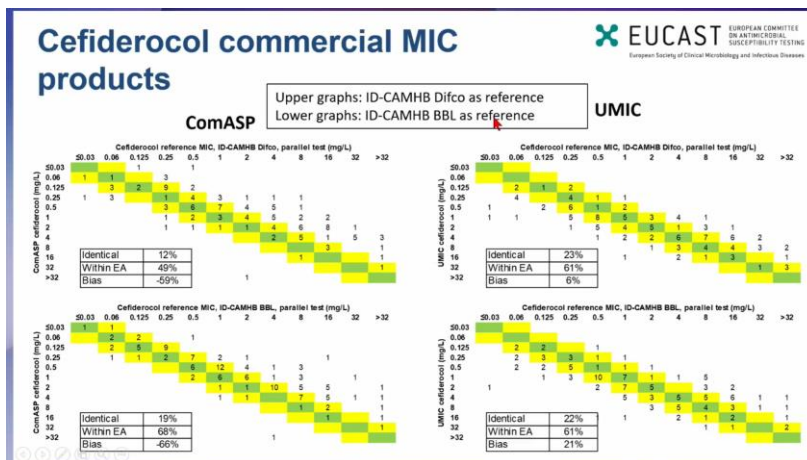

Presentatie Christian Giske, ESCMID Global 2024